


【装置全景-1】



【装置接続例】

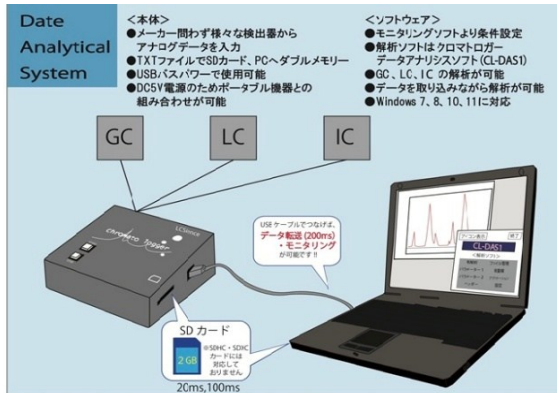


【装置全景-2】



【装置背面および側面】



【取得データ処理例】

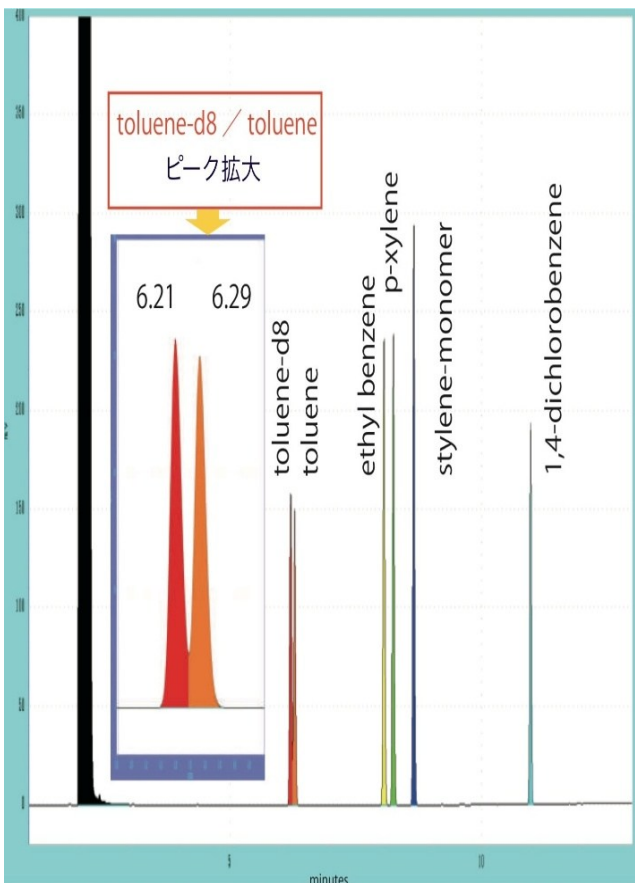

【ChromatoLogger 接続および測定画面例】

測定チャート例

スタート入力端子
検出器入力端子

スタートボタン
stop ボタン

USB BUS 差し込み口

SD カード 差し込み口

SHIMADZU
Maxima GC-2030

◆高価で特別なインターフェイスは必要無く、ChromatoLoggerとパソコンをUSBケーブルで接続するのみ!