


【シッパー前面】




【装置全景】



【シッパー拡大】



【スキャン測定例】

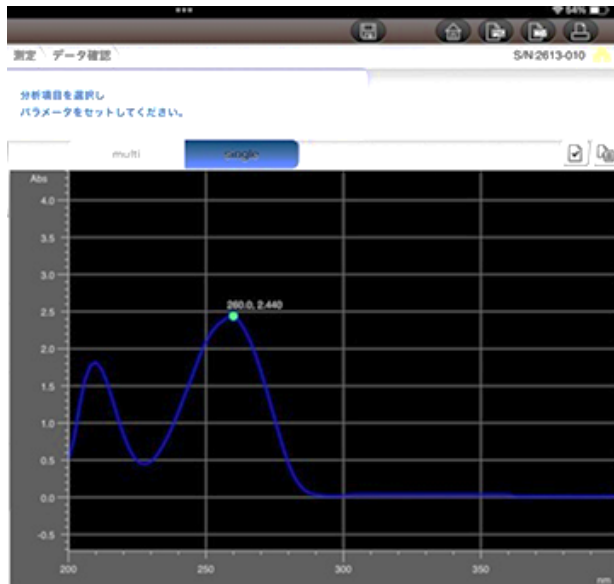

【定量用検量線例】



【結果統計演算例】

16:44 6月5日(水) データ確認  
トップ 測定項目選択 測定条件設定 測定 データ確認 S/N:2613-010

検量線 STD サンプル

サンプルID	Abs	濃度 (mg/L)
Uraai-38ppm-1	0.479	38.33
Uraai-38ppm-2	0.479	38.35
Uraai-38ppm-3	0.479	38.35
Uraai-38ppm-4	0.479	38.34
Uraai-38ppm-5	0.479	38.33
MEAN		38.34
SD		0.01

統計演算  
OFF ON  
実行