


【表示部】



【装置全景+側面】



【装置側面-1,2】

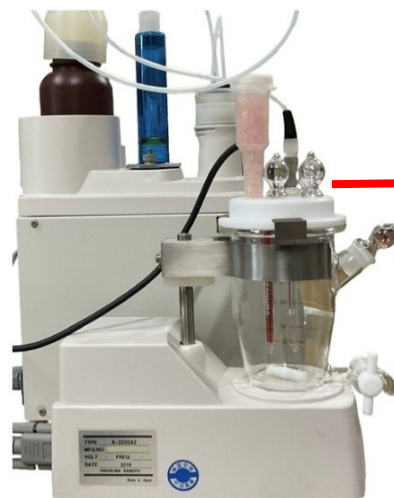

【ユニット拡大】



【表示部拡大】



【反応ユニット+送液ユニット】



【装置側面拡大】



HIRANUMA

757 \* スタンバイ QD H.No. 0 S.No. 1

結果リスト (内部メモリ) 結果数 [ 2 ]

N.o.	測定日	測定時刻	S.No.	濃度
1	06/26	10:32	1	5.2242 mg/mL
2	06/26	10:45	2	16.9277 %

【A】【B】【C】で処理が切り替わります

メニュー 詳細 印刷 総計計算 【A】

注意  
発火注意  
火気厳禁